


















SIAM

HOSPITAL SUPPLY CO., LTD.



ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฉพ.1125/2562







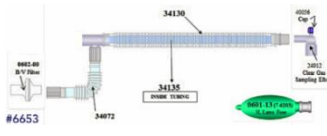









 <p>Riester ไฟส่องตรวจ แบบสวมศีรษะ ri-focus LED No.6091</p>	 <p>Riester ปากกาส่องตรวจ No.5071-526 blue No.5075-526 black No.5072-526 green No.5077-526 slate grey No.5074-526 silver No.5078-526 white</p>	 <p>Riester เครื่องวัดความดันตา No.5110 Schiötz A Tonometer No.5112 Schiötz C Tonometer</p>	 <p>Riester ชุดตรวจตา ri-scope L ophthalmoscope L2 XL 2.5V No.3723</p>
 <p>Riester ชุดตรวจหูหัดถถการ ri-scope OP otoscope HL 2.5 V No.3850.002</p>	 <p>Riester ชุดตรวจหูหัดถถการ, ชุดตรวจตา OP-otoscope/ophtalmoscope HL 2.5V No.3858.003</p>	 <p>Riester ชุดตรวจ หู ตา ri-scope L F.O. oto-L3/ophtal. L2 XL 2.5V No.3745</p>	 <p>Riester ชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก ri-scope de luxe oto-L3/ophtalm. L2 XL2.5V No.3771</p>
 <p>Riester ชุดตรวจ หู ตา พกพา รุ่น e-scope F.O. No.2111-202 Otoscope XL 2.5V,black No.2131-203 Otoscope/Ophthalmoscope LED 3.7V, black</p>	 <p>ME No.808-824-25 ชุดตรวจ หูหัดถถการ No.808-820-25 ชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก No.808-816-25 ชุดตรวจ หู ตา</p>	 <p>Riester ชุดตรวจติดผนัง ri-former Extension module No.3656, 300, 3655-109</p>	 <p>Riester ชุดตรวจตา แบบสวมศีรษะ All pupil II LED No.3994</p>
 <p>Jumper เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด Infrared Thermometer No.JPD-FR100+</p>			 <p>Riester โคมไฟส่องตรวจ Ri-magic HP LED No.6252</p>

คำเตือน

- อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
- ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกายหรืออาบน้ำ

บริษัท สยาม ฮอสปิตาล ซัพพลาย จำกัด 38/1-38/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-090-2330 แฟกซ์: 02-002-7596 e-mail : siamhos@siamhos.com, website : www.siamhos.com

 <p>ชุดส่องตรวจหลอดลม No.810-831-03 Macintosh Standard Laryngoscope Set #Blade1,2,3,4</p> <p>สามารถเลือกซื้อแผ่นส่องตรวจเพิ่มเติมได้ Miller Laryngoscope Blades No.810-211-00 – No.810-211-05 #Blade 0,1,2,3,4,00</p>	 <p>ชุดส่องตรวจหลอดลม No.810-801-03 Macintosh F.O. Laryngoscope Set #Blade1,2,3,4</p> <p>สามารถเลือกซื้อแผ่นส่องตรวจเพิ่มเติมได้ Miller Fiber Optic Blades No.810-031-00 – No.810-031-05 #Blade 0,1,2,3,4,00</p>	 <p>ชุดช่วยหายใจมือบีบ Dispo-Bag™ Manual Resuscitator No.2338 Adult No.2318 Child</p>	 <p>ชุดดูดเสมหะ มือบีบ Smile-Vac Handheld Suction No.1411</p>
 <p>เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8F Oxygen Concentrator No.8F-3AW , No.8F-5AW</p>	 <p>เครื่องวัดความดันโลหิต Upper Arm type Electronic Blood Pressure monitor No.YE670A , No.YE670D</p>	 <p>ชุดสายดมยา Uni Lim Circuit 60™ No.6653</p>	 <p>เครื่องพ่นละอองยา แบบกระเป๋าทัว รุ่น AEROFLAEM No.NA15P00</p>
 <p>เครื่องดูดเสมหะ Portable phlegm suction unit No.7E-A , 7E-D (มีแบตเตอรี่)</p>	 <p>ชุดดูดเสมหะ มือบีบ Manual suction apparatus No.7B-1</p>	 <p>เครื่องพ่นละอองยา Ultrasonic nebulizer No.402AI</p>	 <p>เครื่องมือผ่าตัดทางกายภาพ No.MB-130-13 Needle Holders, HALSEY, 13cm No.KE-102-11 Thumb and Tissue Forceps, THUMB 11,5cm No.KC-102-13 Operating Scissors, Standard 13,0cm</p>
 <p>หูฟังทางการแพทย์ Stethoscope duplex® 2.0 No.4210-01 - No.4210-05 Stainless steel No.4200-01 - No.4200-05 Aluminium No.4220-02 – No.4220-05 for baby No.4230-02 - No.4230-05 for Neonatal</p>	 <p>เครื่องพ่นละอองยา รุ่น PRIMO.NEB No.PN03P00</p>	 <p>หน้ากากดมยาสำหรับสัตว์ Animal Masks Set No.5621</p>	

คำเตือน - อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ - ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง - เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั้น ควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยา - ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้นอนที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน

บริษัท สยาม ฮอสปิเทล จำกัด 38/1-38/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-090-2330 แฟกซ์: 02-002-7596 e-mail : siamhos@siamhos.com, website : www.siamhos.com